固定污染源烟气排放连续监测

系统比对监测报告

项目名称：[illegible]

委托单位：[illegible]


监测类别：[illegible]


报告日期：[illegible]

报 告 编 写：

审 核

附件 1：自动监测设备信息一览表

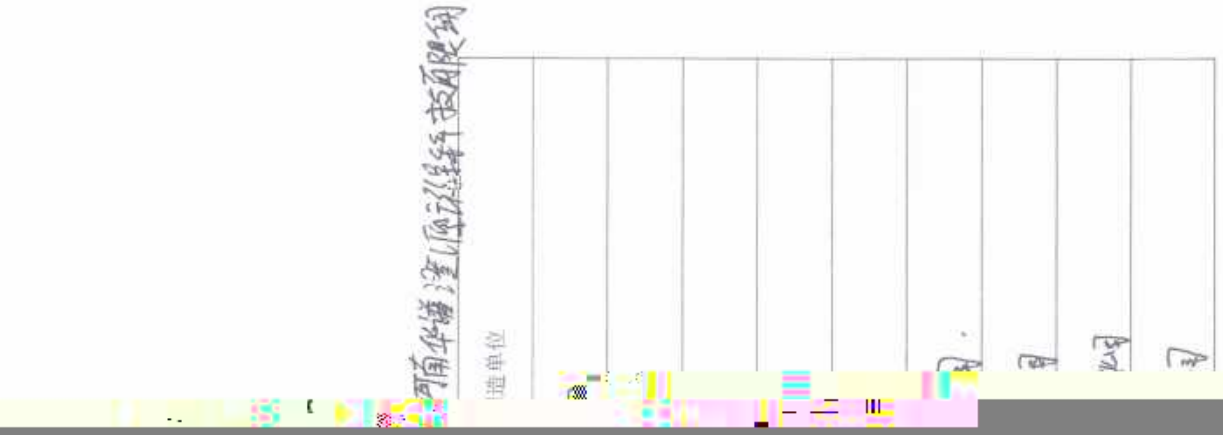

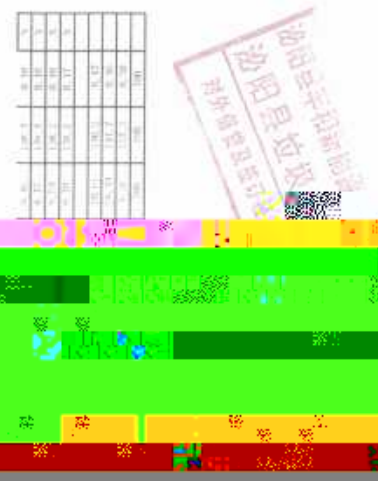

附件 3：比对检测原始记录表

INZYT-IV-CY/HJ-083/D/1

温度（℃）	含湿量（%）
14.2	28.11
40.1	29.06
38.0	25.54
13.8	27.89
-7.6	27.43

氢气 CMS/气态污

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目：Co　　测试人员：杨静　邱紫晚

测试地点：[illegible]　　测试点位：[illegible]

参比方法仪器生产厂家：[illegible]　　型号、编号：[illegible]

测试日期：[illegible]

氧气 CMS/气态污染物 CEMS 比对数据报表

检测项目：[illegible]　　测试人员：[illegible]

测试地点：[illegible]　　测试点位：[illegible]

参比方法仪器生产厂家：[illegible]　　型号、编号：[illegible]

测试日期：2023年 4月 12日　　原理：硝酸银容量法

样品编号	时间（时、分）	参比方法（RM）A	CEMS 法 B	数据对差=B-A
		mg/m³ 干基	mg/m³ 干基 %	

附件 4：检测报告

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度（m）

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	采样日期	检测时段	检测结果	单位	排气筒高度（m）
	氯化氢	2023.4.12	14:38-15:38	16.6	mg/m^3	
			15:54-16:54	14.6	mg/m^3	
			17:[illegible]	[illegible]	mg/m^3	