191412341355

检测报

Test Re

报告编号：

项目名称：鄱阳县绿[illegible]焚烧[illegible]东方[illegible]再生[illegible]

运维单位：[illegible]发电[illegible]鄱阳县[illegible]

（检[illegible]验检测[illegible]

江[illegible]
JIANGXI TOPS[illegible]拓谱思检[illegible]测技[illegible]
[illegible] DETECT[illegible]ON T[illegible]

报告声明

(1) 本公
公司
任，
检测的
科学性、公正性和准确
(2) 根据
委托单位
客户
所提供
的样品和技术资料
量的变
检测要
求，我
们作出此报告。如
化，
(3) 对本
公司将
不为此
承担任何责任。
报告
理期内
有异议
，请及
时向本公司提出，
(4) 本报
报告发
出之日
起十日内。
告涂
本公司
无效，
(5) 如客
无复核、无审核、无授权
检验
测专用
章、骑
缝章及无资质认定
户没有
(6) 本报
特别要
求，本
公司报告不提供检
告代
置，对
样负
责，检
测余样如无约定将
(7) 本报
存、复
现的样
品不受理申诉。
告数
和处置
针对
次采
样样品负责，检测
置，对
(8) 未经
法保存
、复现的样品不受理申诉
本公
司
(9) 本报
面批准，
不得部分复制或引用
告不得用于公证。

江西[illegible]石谱思
[illegible]南昌市[illegible]南昌高

报告编号：TPSLY[illegible]2412

项目名称

项目地址

委托单位

联系人

电话

电子邮箱

报告编制：

审核：

报告

一、

克麦

化氢、

有限公

监控设

二、

【201


2017)

其修

三、核指标要求

根[illegible]《关于加[illegible]强[illegible]后续[illegible]
【2019[illegible]】64[illegible]号、污[illegible]染源[illegible]监测[illegible]比对[illegible]
[illegible]1 固[illegible]污染源

检测项目		
颗粒物	准确	排放[illegible]度均值 ＞2[illegible]g/m³ 时 100[illegible]m³＜排 50 m[illegible]³＜排 20 m[illegible]³＜排 10 m[illegible]³＜排 排放[illegible]度≤10
二氧[illegible]化硫	准确	排放[illegible]度均值 ≥2[illegible]nol/mo 50μ[illegible]mol（ 30μ[illegible]mol（ 20μ[illegible]mol（ 30% 排放[illegible]≤20
氮氧[illegible]化物	准确	排放[illegible]均值 ≥2[illegible]ol/mo 50μ[illegible]ol（ 20μ[illegible]ol（ 20μ[illegible]ol（ 30% 排放[illegible]＜20
一氧化[illegible]碳	准确	排放[illegible]均值 ≥2[illegible]ol/mo 50μm[illegible]ol（ 20μm[illegible]ol（ 20μm[illegible]ol（2 30% 排放[illegible]＜20μ
烟气[illegible]温度	准确	绝对[illegible]差不超过
烟气[illegible]湿度	准确	烟气[illegible]平均值 ＞5.0[illegible]相对 ≤5.0[illegible]，绝对
烟气[illegible]流速	准确	烟气[illegible]平均值 流速[illegible]m/s 时 流速[illegible]m/s 时
含氧[illegible]量	准确	＞5.0[illegible]，相对 ≤5.0[illegible]，绝对
氯化[illegible]氢	准确	排放[illegible]均值： ≥25[illegible]ol/mol 50μm[illegible]ol（8 30% 排放[illegible]＜20μ

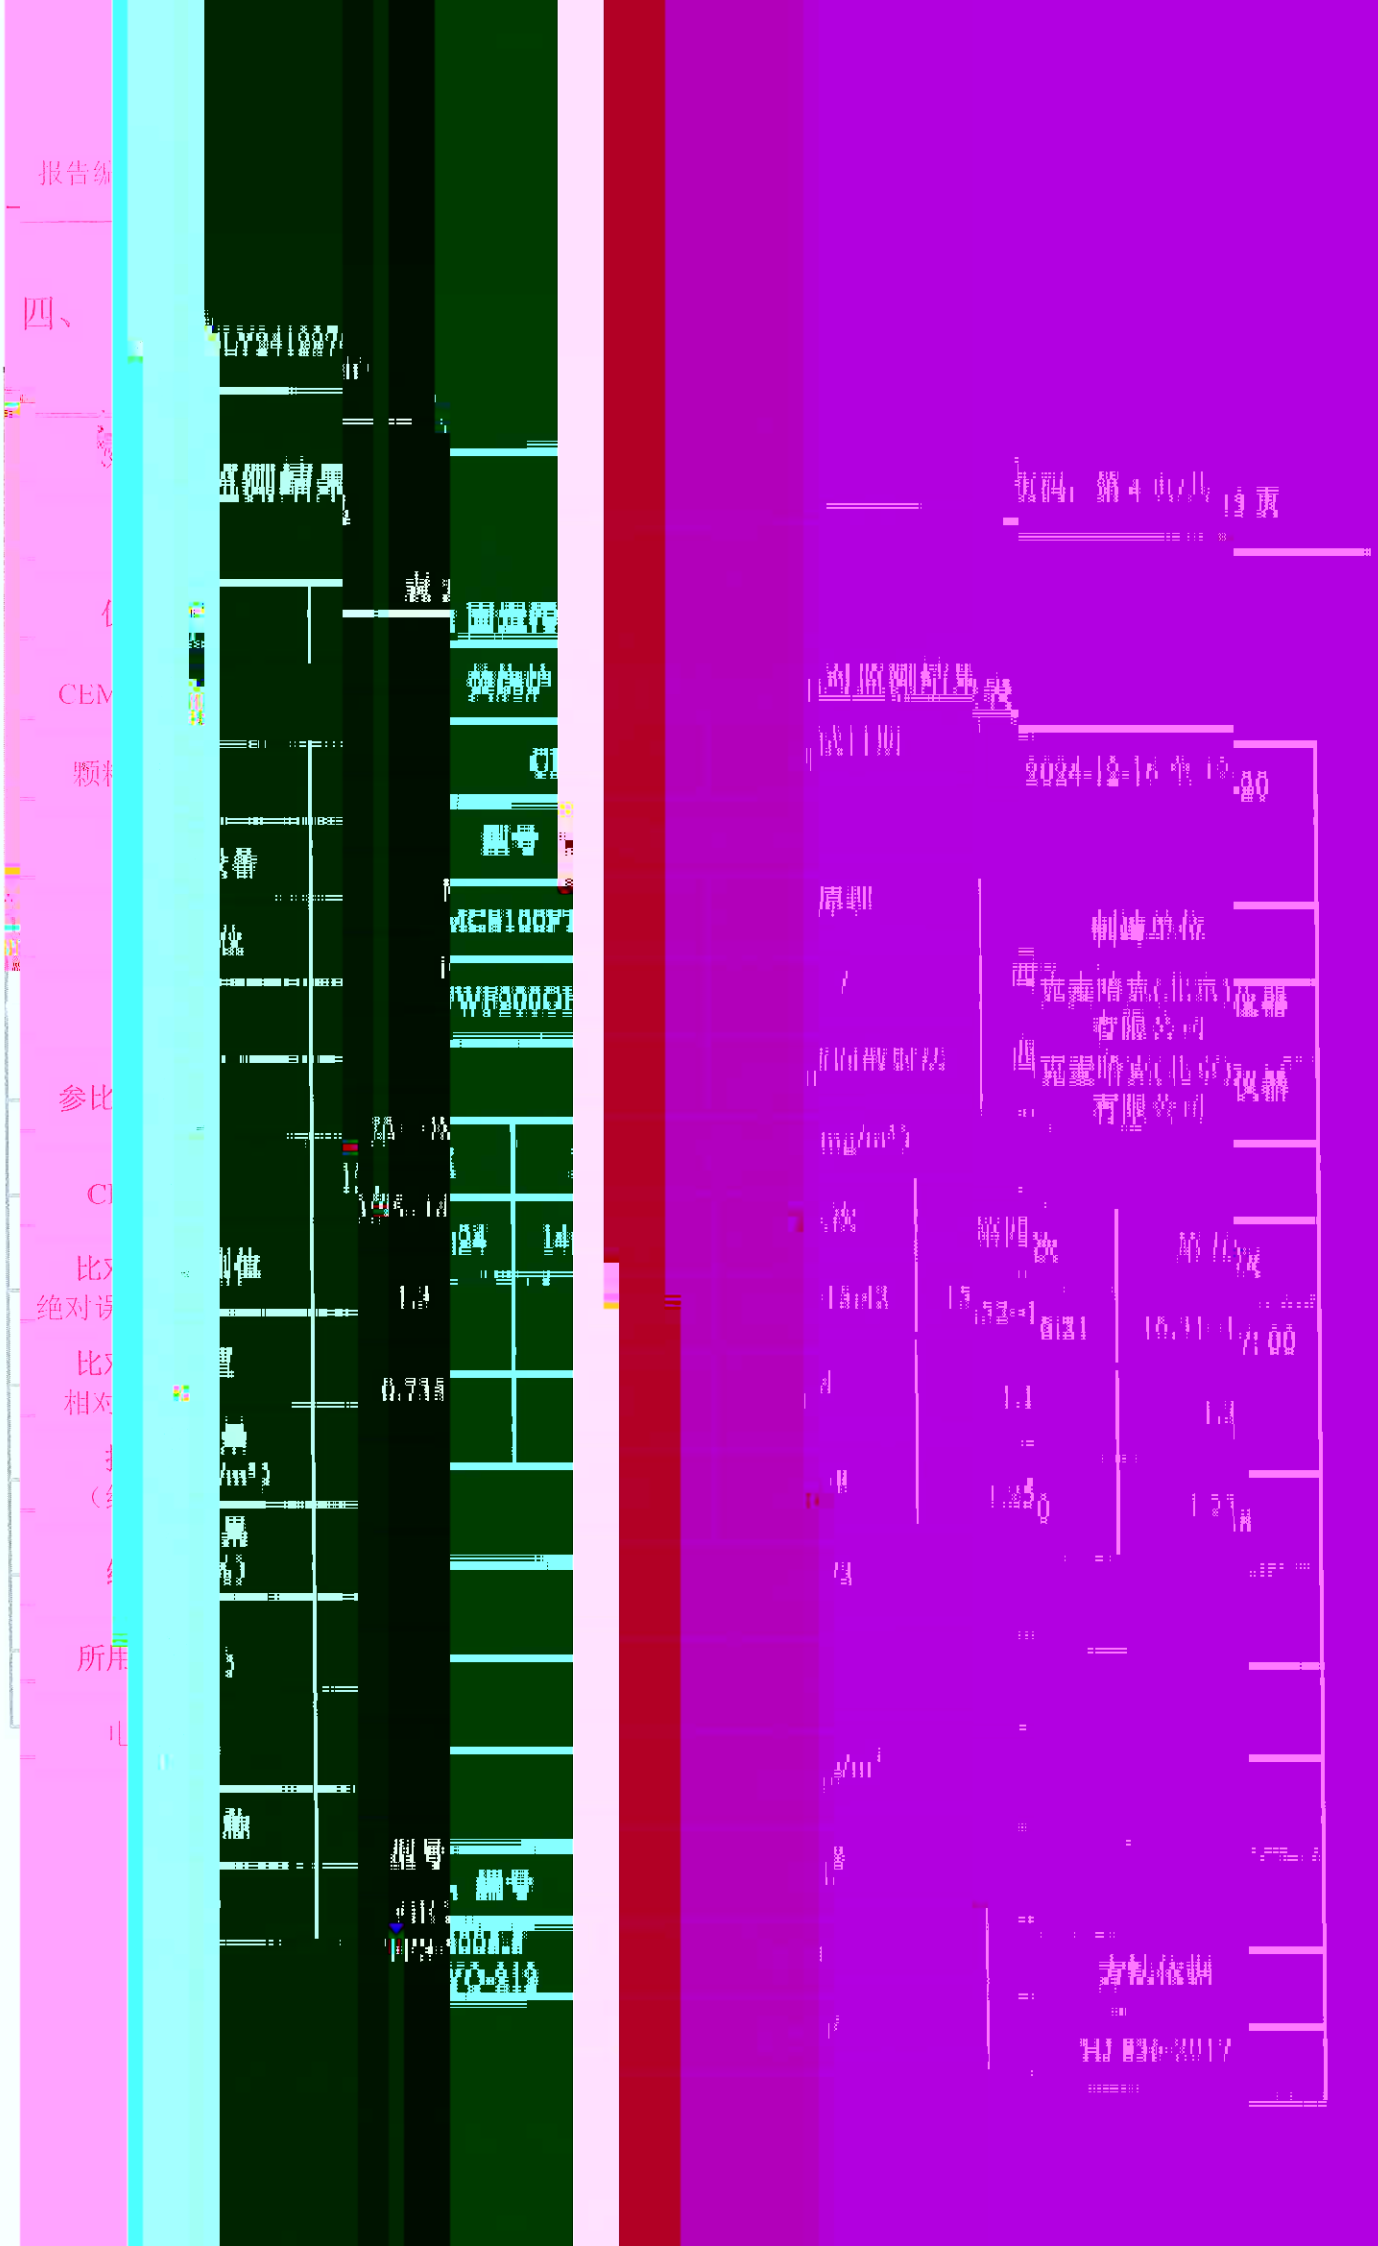

24-
2-16
制造
单位
哈克(
有限公司(北京)仪器
哈克(
有限公司(北京)仪器
第五次
16
:31~17:00
142
142.58
法依
据
161
5
7-1996

报告编号：TPSLY2412274C

续表

	测试点位	焚
	仪器名称	
CE	MS 在线设备	MC
湿	度分析仪	MCS10
	项目	
	次数	第一次
	时间	13:55~14:24
参	比方法实测值	22.4
C	E MS 数值	22.41
比	对监测结果	
绝	对误差（%）	
比	对监测结果	
相	对误差（%）	
	技术要求	
	相对误差）	
	结果评定	
所	用仪器名称	型号、编
大流量	烟尘（气）测试仪	YQ3000 TPS-YQ-0





告编号

表

测试点	
仪器名	
MS 在线	
氯化氢分	
项目	
次数	
时间	
比方法	
EMS	
对监	
绝对	
(mg/	
对监	
对误差	
技术	
绝对	
结果	
用仪	
见分光	

续表

测试点位											
仪器名称	CEMS主要仪器										
CEMS在线设备	型号										
二氧化硫分析仪	原理										
项目											
次数	第一次										
时间	13:49~										
参比方法	实测值	30									
CEMS	数值	26.998									
比对监测结果绝对误差（mg/m³）											
比对监测结果相对误差（%）											
技术要求（绝对误差）											
结果评定											
所用仪器名称	型号										
大流量烟尘（气）测试仪											

测试日期											
2024-12-16											
型号											
原理											
/	西										
高温傅立叶	西										
二氧化硫（mg/m³）											
第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次						
15:46~15:50	16:25~16:29	17:04~17:08	17:2~17:3	17:52~17:56	8:16~8:20						
12	39	22	40	10	2						
2.743	44.375	20.643	48.07	2.370	1						
-1.629					8.612						
/											
17 mg/m³											
合格											
原理											
电位电解法											

制造单位
克麦哈克(北京有限公司
克麦哈克(北京有限公司

方法依据
HJ 57-2017

续表

测试点位	焚	测试日期	2024-12-16
仪器名称	型	原理	制造单位
CEMS 在线设备	MCS	/	西克麦哈克(北京)有限公司
氮氧化物分析仪	MCS100E	高温傅立叶	西克麦哈克(北京)有限公司
项目	氮氧化物（mg/m³）		
次数	第一次	第二次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第
时间	13:4~13:5	14:28~14:32	16:46~16:50	17:25~17:29	17:04~17:08	17:28~17:32	17:5~17:56	16:~
参比方法实测值	219	249	161	207	199	177	161	8:L次 18:16~20
CEMS 数值	225.6	252.54	150.785	206.226	206.013	181.621	161.57	1
比对监测结果绝对误差（mg/m³）	1.020							300
比对监测结果相对误差（%）	/							
技术要求（绝对误差）	≤41 mg/m³							
结果评定	合格							
所用仪器名称	型号、编号	原理	方法依据
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D TPS-YQ-062	定电位电解法	HJ 693-2014

续表

测试点位		焚烧		
仪器名称		型号		
CEMS在线设备		MCS10		
一氧化碳分析仪		MCS100FT-		
项目				
次数		第一次	第二次	
时间		13:49~13:53	14:28~14:32	1
参比方法实测值		6	4	
CEMS数值		0.000	0.000	0
比对监测结果绝对误差（mg/m³）				
比对监测结果相对误差（%）				
技术要求（绝对误差）				
结果评定				
所用仪器名称		型号、编号		
大流量烟尘（气）测试仪		YQ3000-D TPS-YQ-062		

